


# Diagrama de flujo para aprobación de ventiladores invasivos en México durante la contingencia COVID-19

# FLUJOS PARALELOS DE APROBACIÓN



# FLUJO DE APROBACIÓN DE PRODUCTO

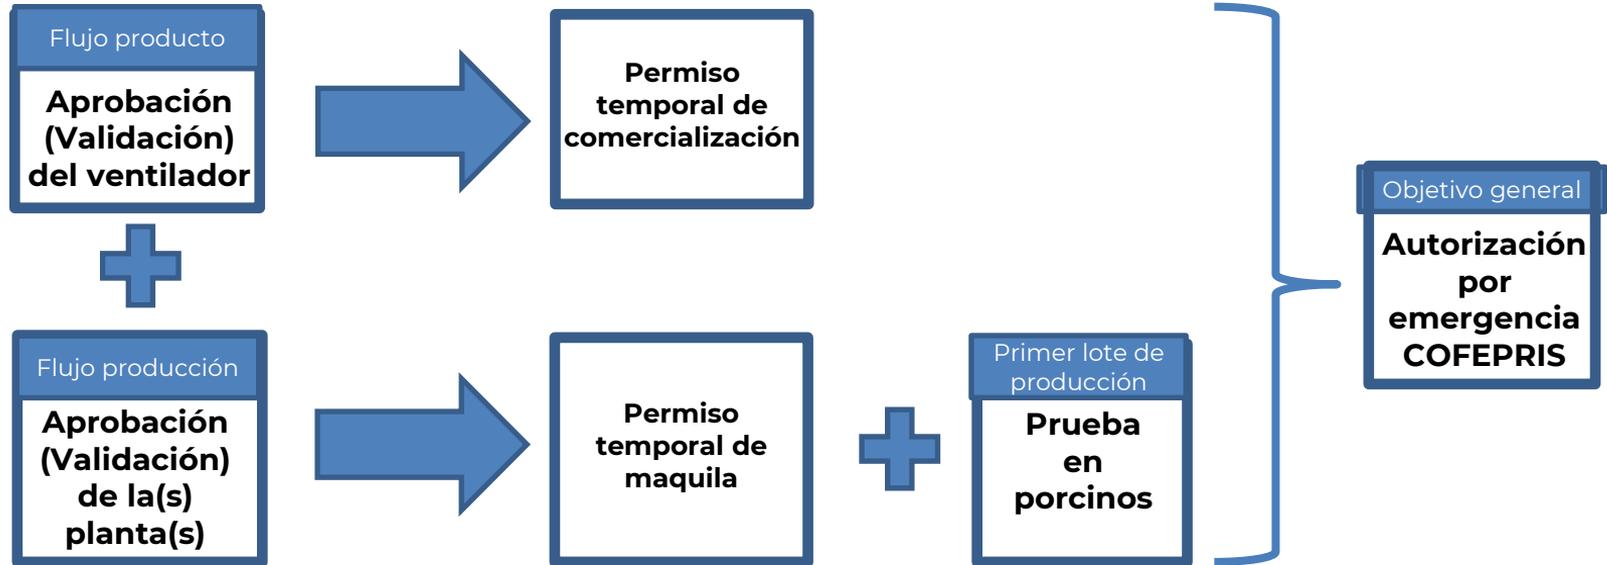


CONACYT

INCMNSZ


INER/ INCMSZ

COFEPRIS

# FLUJO DE APROBACIÓN DE PLANTA(S)

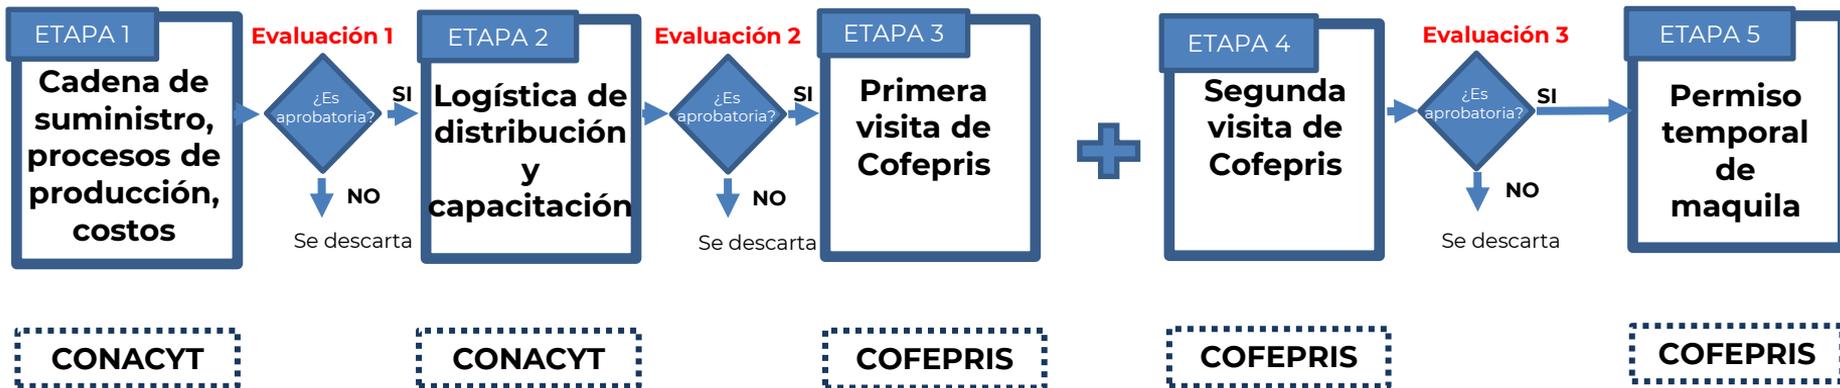

# SEGUIMIENTO DE PRIMERA PRODUCCIÓN

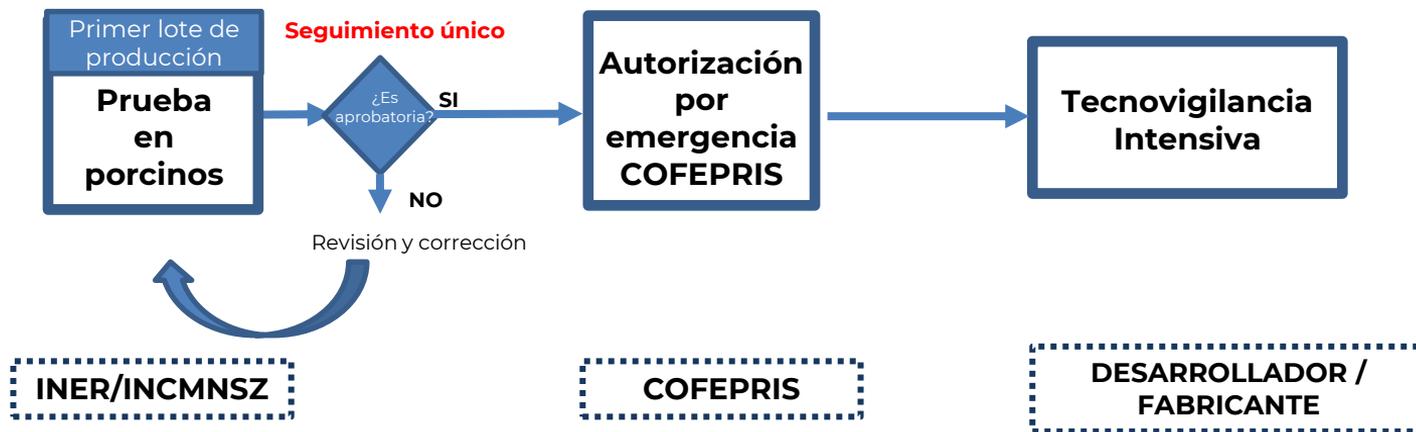

## Consideraciones generales



- Ambos flujos de aprobación deben correr en paralelo en virtud de acortar los tiempos.
- Las entidades responsables de las evaluaciones trabajarán de manera colegiada con expertos en el área y se generarán los documentos correspondientes de estas actividades.
- Cada entidad responsable tiene un rol establecido, siendo el enfoque conjunto muy importante para construir las dinámicas de colaboración.
- Una vez concluida la contingencia, los proponentes deberán someter el dossier completo para la obtención del registro sanitario como establecen los lineamientos de COFEPRIS.

# GRACIAS

---